CinnoRA®
Adalimumab

دستورالعمل نحوه استفاده از فیزیوجکت (ابزار داروررسان خودکار)

شرکت سیناژن
CinnaGen

شرایط نگهداری

- فیزیوجکت را در یخچال در دمای ۸-۲ درجه سانتی‌گراد و دور از دید و دسترس کودکان نگه دارید.
- فیزیوجکت را از قراردادن در معرض نور مستقیم خورشید محافظت کنید.
- فیزیوجکت برای تزریق یک دوز دارو است و تنها برای یکبار تزریق قابل استفاده است.
- از تکان دادن شدید فیزیوجکت خودداری کنید.
- قبل از مصرف، تاریخ انقضا درج شده بر روی فیزیوجکت را چک کنید.
- فیزیوجکت را گرم نکنید و از فریز کردن آن جدا خودداری کنید.
- بهتر است همیشه فیزیوجکت را در بسته‌بندی اصلی دارو نگهداری کنید.

آماده‌سازی قبل تزریق

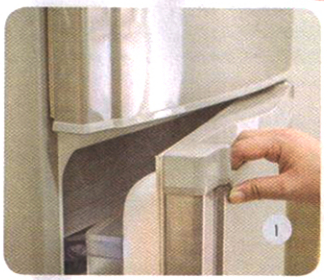

۱ فیزیوجکت را از یخچال خارج کرده و مدتی صبر کنید تا با محیط هم دما شود.

۲ دست‌های خود را به‌خوبی با آب و صابون بشویید.

انتخاب محل تزریق

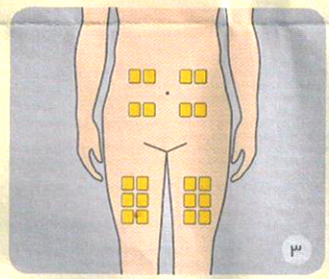

۳ بهترین نواحی برای تزریق عبارتند از: جلوی ران و نواحی شکم با فاصله ۵ سانتی‌متر از اطراف ناف. در هربار تزریق بخش متفاوتی از نواحی ذکر شده را برای تزریق انتخاب کنید.

مراحل تزریق

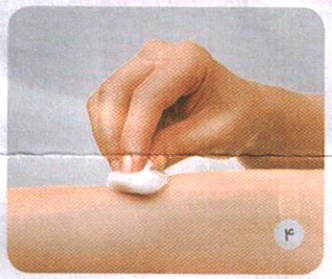

۴ محل تزریق را با پنبه الکلی به صورت دورانی از داخل به خارج ضدعفونی کنید. اجازه دهید الکل با جریان هوا خشک گردد. از فوت کردن محل تزریق خودداری نمایید.

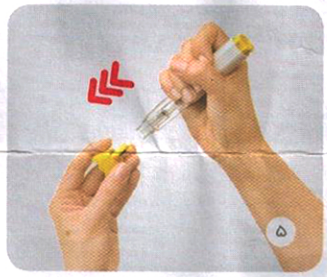

۵ قسمت نگهدارنده فیزیوجکت را طبق تصویر با دست نگه دارید و از دست دیگر خود برای برداشتن درپوش دستگاه استفاده کنید. درپوش دستگاه را به صورت مستقیم از روی دستگاه برداشته و از پیچاندن آن خودداری کنید. تنها پیش از تزریق، درپوش دستگاه را بردارید. به محض برداشتن درپوش، تزریق باید انجام گیرد.

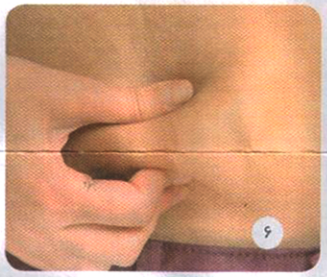

۶ فیزیوجکت را با یک دست گرفته و با دست دیگر برآمدگی کوچکی در محل مورد نظر برای تزریق ایجاد کنید.